

Wypełnij poniższe pola celem określenia charakterystyki i właściwości wyrobu.

WYRÓB SERYJNY WYRÓB INDYWIDUALNY

APARAT / ORTEZA STAWU KOLANOWEGO

■ **MODEL**

- ERH 46
 ERH 46/1
 ERH 46/2

■ **WERSJA**

- prawa noga
 lewa noga

■ **MATERIAŁ**


- higromed
 activedry

■ **ZAMEK STAWU**



- ERH 2**
 Dwuosiowy bez regulacji kąta zgięcia i wyprostu

- ERH 2R**
 Dwuosiowy z regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 20°

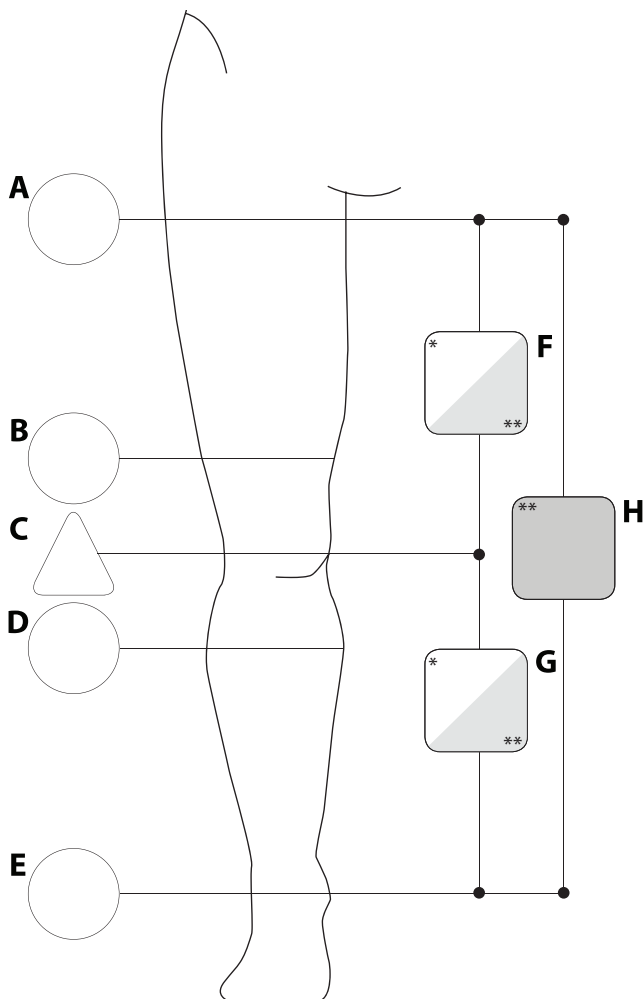

* rzeczywista długość odcinka
 ** oczekiwana długość elementu

DANE PACJENTA

Kod pacjenta

Wzrost Wiek Waga Płeć (K/M)

Uwagi dotyczące dysfunkcji

Lekarz prowadzący

DANE SKLEPU

Firma NIP

Adres dostawy

Telefon / Osoba kontaktowa

Data pomiaru Data odbioru Data dostarczenia

Podpis i pieczęćka

ERHEM

Data przyjęcia Data dostarczenia

Uwaga! Za błędy w pomiarach odpowiada zamawiający.

UWAGI

- A:** obwód uda na wysokości pachwiny
B: obwód uda 10 cm nad stawem kolanowym
C: obwód przez staw kolanowy
D: obwód przez brzusiec mięśnia trójgłowego
E: obwód przez staw skokowy
F: szpara stawu kolanowego – pachwina
G: szpara stawu kolanowego – staw skokowy
H: długość całkowita aparatu